


# VIDA-GT Series

Dosiercomputer

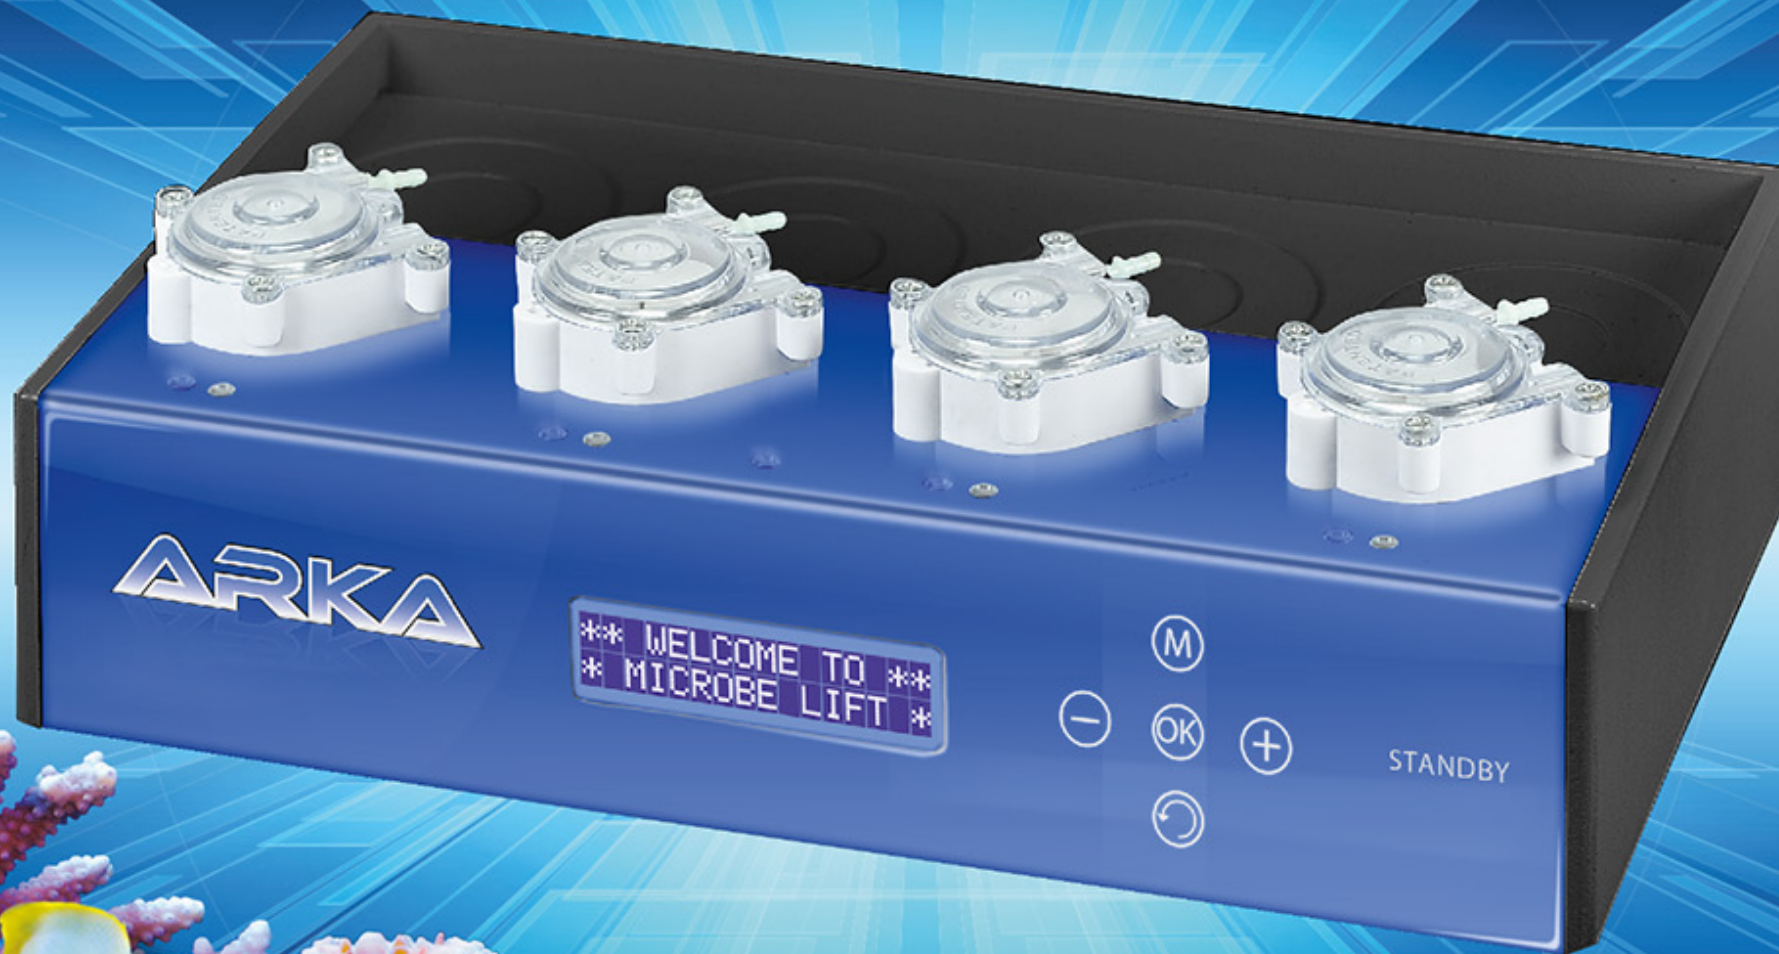

**4-Kanal Dosieranlage**

- Erweiterbar auf 8 Kanäle



**Magnetrührer**

- Rührintervall: 120 sek. alle 30 min. & vor jedem Dosiervorgang



**Schlauchentleerung (Rücksaugung)**



**Menü-Sprachen**

- Deutsch, Englisch, Französisch



**Dosiermenge**

- 1-1999 ml/Kanal je Vorgang



**Dosierzeiten**

- Einstellbar: 0 – 24 Stunden




**Dosiergenauigkeit**

- ca. +/- 2% nach der Kalibrierung



**Dosierintervalle**

- Periodisch: 1-30 Tage / 1-24 Std.
- 6 individuell programmierbare Dosierzeiten pro Tag/Kanal
- Einzelprogrammierung der Wochentage

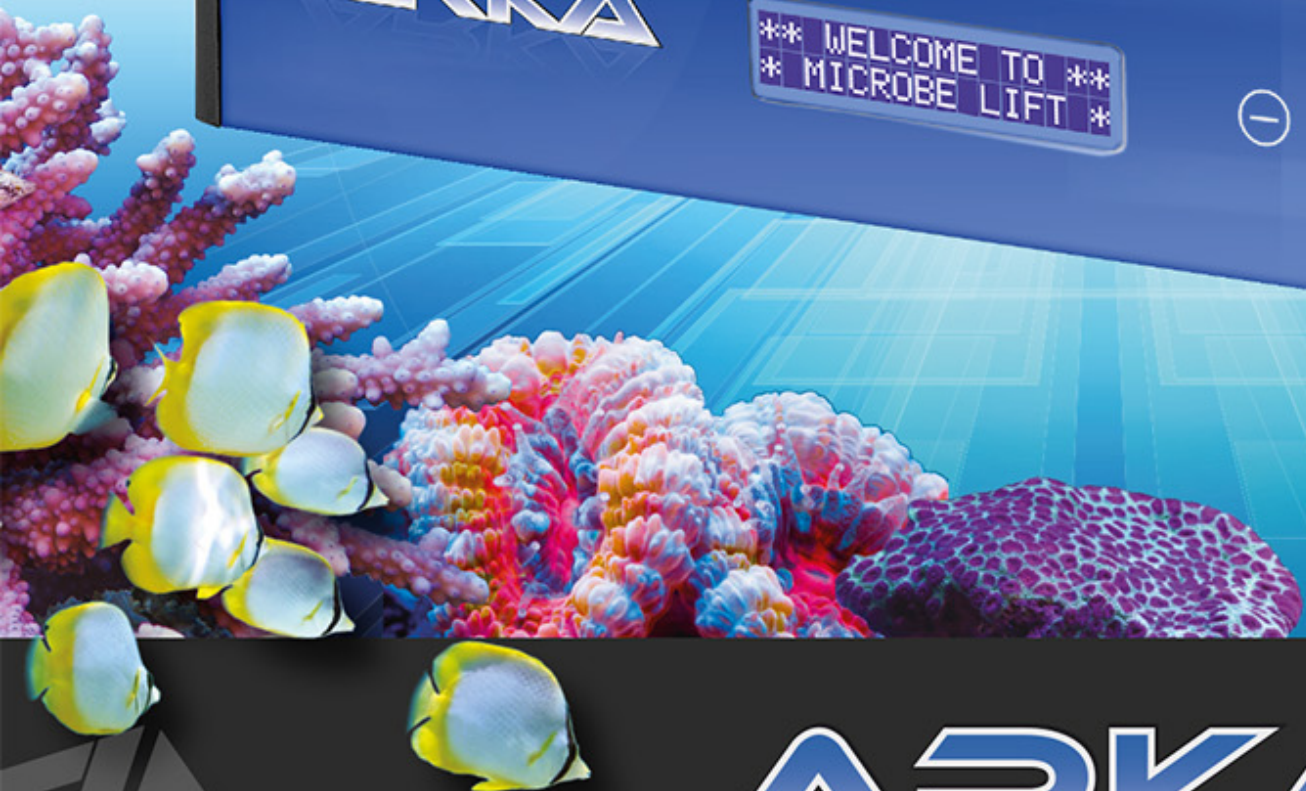

**ARKA**®

VIDA - G T Series